

人Galectin 3双抗夹心ELISA检测试剂盒

请在实验前仔细阅读本说明书

产品货号: KE00311
规格: 96T
灵敏度: 0.01 ng/mL
检测范围: 0.156 - 10 ng/mL
用途: 此试剂盒用于定量检测血清、血浆以及细胞上清中的人Galectin 3浓度

本产品仅用于科学研究，不适用于临床诊断


目录

一：背景信息	3
二：检测原理	3
三：需自备的实验器材	3
四：试剂盒组分及储存	4
五：实验注意事项	4
六：样本准备	4
七：试剂准备	5
八：实验步骤	6
九：实验参数	7
9.1 参考标曲图	7
9.2 精密度	7
9.3 加标回收率	8
9.4 样本值	8
9.5 灵敏度	8
9.6 线性	9
十：参考文献	9

一：背景信息

半乳糖凝集素 (Galectins) 是一类能够特异性结合 β -半乳糖的动物凝集素。半乳糖凝集素3是一个分子量为31 kDa的 β -半乳糖结合蛋白，具有三个结构域，分别是富含脯氨酸和甘氨酸的N端结构域，富含甘氨酸、酪氨酸、脯氨酸串联重复序列的类胶原结构，以及C端的糖识别结构域 (CRD)。半乳糖凝集素3在很多正常组织以及肿瘤组织中均由表达。它在细胞内分布于细胞核和细胞质，同时也可以被分泌到细胞外，存在于细胞外基质。它参与细胞生长、细胞黏附、细胞分化、细胞凋亡、血管生成、免疫应答、肿瘤的转化及转移等多项生命活动。在乳腺癌、胃肠道癌、肺癌或卵巢癌、黑色素瘤和非霍奇金淋巴瘤患者的血清中，均发现有该蛋白水平的上升。

二：检测原理

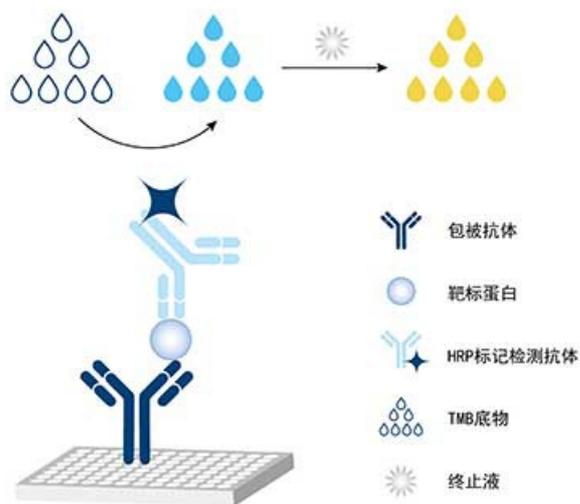

◀双抗夹心模式图 (检测抗体直标HRP)

按操作顺序形成抗体夹心结构后，加入TMB底物，板孔液体由无色变成蓝色，再加入终止液液体变为黄色后进行吸光度值测定。

三：需自备的实验器材

- 3.1 酶标仪 (可读取450 nm和630 nm双波长);
- 3.2 高精度移液器及一次性移液器枪头;
- 3.3 洗板机 (亦可手动洗板);
- 3.4 EP管 (用于稀释标准品及样本);
- 3.5 吸水毛巾或滤纸 (用于拍干);
- 3.6 烧杯和量筒;
- 3.7 用于ELISA实验的数据分析的统计拟合软件 (推荐四参数拟合方法)，如：Origin，ELISA Calc等。

四：试剂盒组分及储存

英文名称	中文名称	规格	数量
Microplate	预包被酶标板 - 96孔板	8孔 × 12条	1 块
Protein standard	标准品 - 冻干粉状 *	20 ng/瓶	2 瓶
Detection antibody, HRP-conjugated (100×)	HRP标记检测抗体浓缩液 (100×) **	120 μL/支	1 支
Sample Diluent PT 1-ef	样本稀释液 PT 1-ef (用于人血清和血浆样本)	30 mL/瓶	1 瓶
Sample Diluent PT 4B1	样本稀释液 PT 4B1 (用于细胞上清样本)	30 mL/瓶	1 瓶
Detection Diluent	抗体稀释液	30 mL/瓶	1 瓶
Wash Buffer Concentrate (20×)	浓缩洗涤液 (20×)	30 mL/瓶	1 瓶
Tetramethylbenzidine Substrate (TMB)	显色底物 TMB	12 mL/瓶	1 瓶
Stop Solution	终止液	12 mL/瓶	1 瓶
Plate Cover Seals	封板膜		4 张

储存条件：
1：未开启试剂盒可在2-8℃条件下存放6个月或者在-20℃条件下存放1年
2：已开启试剂盒可在2-8℃存放7天
3：每次实验均使用新的标准品,使用后丢弃

* 使用对应的样本稀释液对标准品进行复溶，复溶过程避免产生气泡

** 开盖前请离心

五：实验注意事项

- 5.1 避免皮肤接触终止液以及TMB 显色液；
- 5.2 在实验过程中，注意穿戴个人防护装备，如实验服，手套，口罩和护目镜；
- 5.3 请勿将不同批次的试剂进行混用，过期产品请勿使用；
- 5.4 在使用自动洗板机时，板孔加入洗涤液之后，设置30秒的浸泡程序，以提高分析的精确度。

六：样本准备

- 6.1 血清：全血标本室温凝固 30 min后1000×g 离心15 min，取上清立即使用或分装后-20℃存放，避免反复冻融。
- 6.2 血浆：可用EDTA、肝素或柠檬酸盐作为抗凝剂，标本采集后1000×g 离心15 min，立即使用或分装后-20℃存放，避免反复冻融
(注意：标本溶血会影响检测结果，因此溶血标本不宜进行检测)。
- 6.3 细胞上清：收集细胞培养液，500×g 离心5 min取上清，立即使用或分装后-20℃存放，避免反复冻融。

七：试剂准备

7.1 洗涤液 (1×)：

如果洗涤液 (20×) 有晶体析出, 37°C加热至晶体全部溶解。按1:20稀释倍数进行稀释: 如取30 mL 浓缩洗涤液 (20×), 加入570 mL 超纯水或去离子水, 得到洗涤液 (1×)。

7.2 HRP标记检测抗体 (1×)：

开盖前瞬时离心, 按1:100比例进行稀释, 稀释前根据预先计算实验所需的总量配制 (100 μL/孔), 实际配制时应多配制0.1-0.2 mL。如10 μL HRP标记检测抗体浓缩液 (100×) 加 990μL 抗体稀释液进行配制, 轻轻混匀。


7.3 待检测样本：

不同的样本使用相应的样本稀释液进行稀释, 如果样本检测值超过标曲最高范围, 可将样本进行一定的稀释后再进行实验, 使样本的检测值处于标曲范围内, 不同样本的稀释倍数需自行优化。

稀释比推荐如下: 人血清和血浆样本1:4稀释; 细胞上清样本1:2或1:4稀释; 样品采集、处理和储存的差异可能导致测值的改变。

7.4 梯度稀释的标准品：

检测人血清和血浆样本, 使用2 mL PT 1-ef样本稀释液复溶标准品; 检测细胞上清样本, 使用2 mL PT 4B1样本稀释液复溶标准品, 具体操作如下:

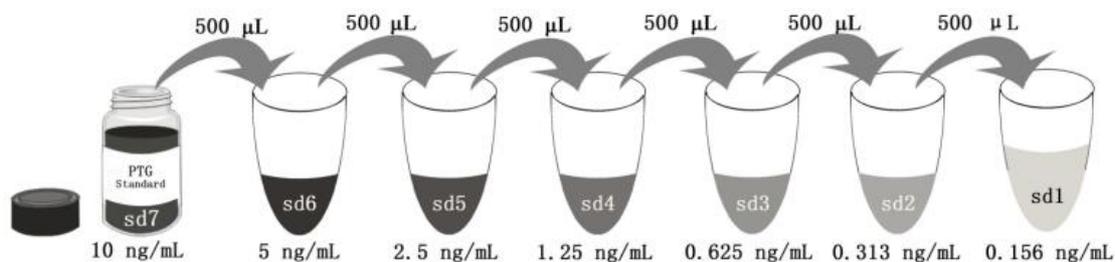

Add # μL of Standard diluted in the previous step	—	500 μL					
# μL of Sample Diluent PT 1-ef or PT 4B1	2000 μL	500 μL					
	"sd7"	"sd6"	"sd5"	"sd4"	"sd3"	"sd2"	"sd1"

八：实验步骤

实验前，需要将所需试剂在室温平衡20-30min（HRP标记检测抗体浓缩液不需要平衡室温，即用即取）；在进行标准品、样本以及不同试剂加样时，更换枪头，避免接触微孔板的内表面，不同的试剂，使用不同的加样槽；

8.1 根据实验用量，取出需要用到的酶标板条，剩余板条加入干燥剂放入铝箔袋密封后存放于4°C，并于一周之内用完；

8.2 加样，分别设零孔、标准孔、待测样本孔。零孔加样本稀释液100 μL，余孔分别加梯度稀释的标准品或待测样本100 μL/孔，注意不要产生气泡（建议标准品和样本都做复孔，尽量避免实验误差，确保上样不间断，5-10 min完成加样）；

8.3 酶标板盖上覆膜，37°C孵育2 h；

8.4 洗涤

1) 揭开封板膜（动作轻柔，避免动作过大导致液体溢出串孔），弃液体，拍干；

2) 洗涤液（1×）洗涤板条，每孔350-400 μL，洗涤后，甩掉液体拍干板条，重复此步骤4次，避免异物进入板孔以及板条干燥；

8.5 每孔加100 μL HRP标记检测抗体（1×）（参照试剂准备部分7.2），盖上封板膜，37°C孵育40 min；

8.6 重复步骤8.4；

8.7 显色：每孔加TMB显色液100 μL，37°C避光显色 15-20 min（如果颜色偏浅，可适当延长显色时间，不超过30 min；保持显色底物始终处于避光状态，显色底物在加样前应是无色透明，如有变色，请勿使用）；

8.8 终止：每孔加终止液100 μL，蓝色变黄色。终止液与TMB显色液的加样顺序一致；（注意：眼睛和皮肤避免接触终止液）

8.9 读数：以630 nm为校正波长，用酶标仪在450 nm波长测量各孔的光密度(OD值)。加入终止液后5 min内进行读数，若无630 nm波长，也可直接使用450 nm 波长读数；


8.10 数据分析：每个标准品和样本的OD值需减去零孔的OD值，设置复孔，取其平均值。以标准品的浓度为横坐标，OD 值为纵坐标，使用专业软件（如Origin、ELISACalc等）进行四参数拟合（4-PL），根据样本的OD值由标准曲线推算出拟合浓度，乘以稀释倍数得到样本的实测浓度。

操作流程如下：


步骤	试剂	体积	孵育时间	洗涤次数	孵育温度
1	标准品或样本	100 μL	120 分钟	4 次	覆膜后37°C孵育
2	HRP标记检测抗体（1×）	100 μL	40 分钟	4 次	覆膜后37°C孵育
3	显色 TMB	100 μL	15-20 分钟	不需要洗涤	覆膜后37°C孵育，避光
4	终止液	100 μL	0 分钟	不需要洗涤	-
5	加入终止液后以630 nm为校正波长，在450 nm处测量OD值，此过程建议不超过5分钟				

九：实验参数

9.1 参考标曲图

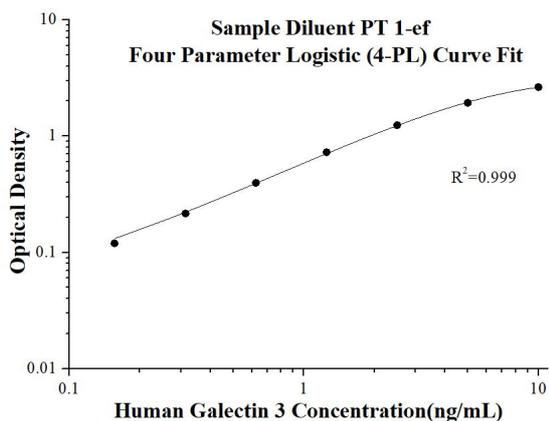

(ng/mL)	O.D	Average	Corrected
0	0.0337 0.0341	0.0339	-
0.156	0.1556 0.1509	0.15325	0.11935
0.313	0.2553 0.2438	0.24955	0.21565
0.625	0.4284 0.4317	0.43005	0.39615
1.25	0.7607 0.7623	0.7615	0.7276
2.5	1.2856 1.2663	1.27595	1.24205
5	1.9534 1.984	1.9687	1.9348
10	2.6698 2.679	2.6744	2.6405

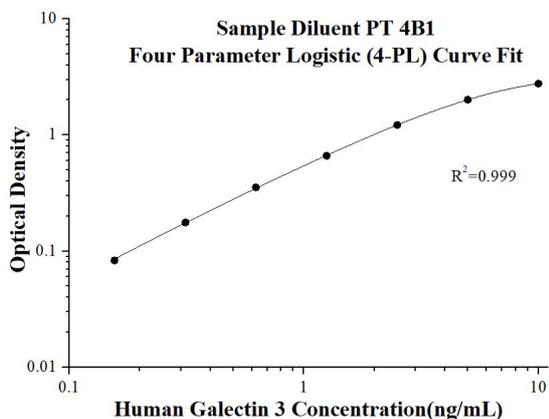

(ng/mL)	O.D	Average	Corrected
0	0.0291 0.0317	0.0304	-
0.156	0.1139 0.1129	0.1134	0.083
0.313	0.2063 0.2066	0.20645	0.17605
0.625	0.3891 0.3779	0.3835	0.3531
1.25	0.7093 0.6732	0.69125	0.66085
2.5	1.2531 1.2497	1.2514	1.221
5	2.0489 2.0337	2.0413	2.0109
10	2.7675 2.8222	2.79485	2.76445

9.2 精密度

板内精密度：3个不同浓度的样本在板内重复测定 20次；

板间精密度：3个不同浓度的样本在板间重复测定 24次。

板内精密度 (CV内)				
样本	数量	平均值 (ng/mL)	标准差	变异系数CV%
1	20	3.91	0.07	1.87
2	20	0.90	0.02	2.22
3	20	0.23	0.01	3.61

板间精密度 (CV间)				
样本	数量	平均值 (ng/mL)	标准差	变异系数CV%
1	24	3.73	0.13	3.38
2	24	0.88	0.03	2.98
3	24	0.23	0.01	4.33

9.3 加标回收率

样本稀释后，在标曲范围内选择高、中、低3个浓度，进行人Galectin 3的加标回收率实验，结果如下：

样本类型	稀释倍数	平均值 (%)	范围 (%)
人血清	1:15	97	88-104
	1:30	95	85-106
细胞上清	1:8	103	93-110
	1:16	110	97-121

9.4 样本值

人血清 - 应用本试剂盒，检测人血清样本中人Galectin 3的浓度。

样本类型	均值 (ng/mL)	范围 (ng/mL)
人血清 (n=16)	4.27	2.61-6.26

细胞上清 - 人外周血淋巴细胞(PBLs)在含有5%胎牛血清、5 μ M β -巯基乙醇、2 mM L-谷氨酰胺、100 U/mL青霉素和100 μ g/mL硫酸链霉素的DMEM中培养。细胞分别在未刺激或用10 μ g/mL PHA和1 μ g/mL Ca^{2+} 刺激下培养6天。收集细胞上清，检测人Galectin 3的水平。

刺激条件	6天 (ng/mL)
未刺激	0.16
刺激	2.24

9.5 灵敏度

用20个重复的零孔平均OD值加上两倍标准差得到的OD值带入标准曲线拟合出对应的浓度值，此试剂盒中人Galectin 3的灵敏度为0.01 ng/mL。

9.6 线性

用对应样本稀释液稀释样本，使稀释后的检测值处于标曲范围内，线性数据如下：

(人血清样本预先稀释2倍。)

		人血清	细胞上清
1:2	均值 (%)	100	100
	范围 (%)	-	-
1:4	均值 (%)	111	112
	范围 (%)	107-115	104-119
1:8	均值 (%)	112	111
	范围 (%)	108-117	106-118
1:16	均值 (%)	114	108
	范围 (%)	108-121	95-119

十：参考文献

1. Barondes SH, et al. (1994) J Biol Chem. 269(33):20807-10.
2. Iurisci I, et al. (2000) Clin Cancer Res. 6(4):1389-93.
3. Takenaka Y, et al. (2002) Glycoconj J. 19(7-9):543-9.
4. Dumić J, et al. (2006) Biochim Biophys Acta. 1760(4):616-35.